



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 02 августа 2023 года № РЗН 2016/4203

На медицинское изделие

**Система ультразвуковая диагностическая Affiniti с принадлежностями**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Общество с ограниченной ответственностью "ФИЛИПС"**

**(ООО "ФИЛИПС"), Россия,**

**123022, Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13**

Производитель

**"Филипс Ультрасаунд, ЛЛС.", США,**

**Philips Ultrasound, LLC., 22100 Bothell Everett Highway, Bothell, Washington,**

**98021-8431, USA**

Место производства медицинского изделия

**см.приложение**

Номер регистрационного досье № РД-55610/28803 от 17.04.2023

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2а**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности **26.60.12.132**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 4 листах

приказом Росздравнадзора от 02 августа 2023 года № 4855  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

0072659

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 августа 2023 года № РЗН 2016/4203

Лист 1

На медицинское изделие

**Система ультразвуковая диагностическая Affiniti с принадлежностями,**  
в вариантах исполнения:

Affiniti 30, Affiniti 50, Affiniti 70, Affiniti CVx:

I. Система ультразвуковая диагностическая в вариантах исполнения Affiniti 30, Affiniti 50, базовый состав:

1. Аппарат ультразвуковой в вариантах исполнения Affiniti 30, Affiniti 50.
2. Шнур питания, длина 2,15 м.
3. Руководство пользователя на бумажных и/или электронных носителях - не более 15 шт.
4. Датчики с линейной матрицей: L12-3, и/или L12-4, и/или L12-5, и/или L15-7ю, и/или L18-5, и/или VL13-5, и/или L12-3 ERGO, РУ № ФСЗ 2010/08784 - не более 15 шт. (при необходимости).
5. Датчики с конвексной матрицей: 3D9-3v, и/или BP10-5ec, и/или C5-1, и/или C6-2, и/или C8-5, и/или C9-4v, и/или C10-4ec, и/или V9-2, и/или mC7-2, и/или V6-2, РУ № ФСЗ 2010/08784 - не более 15 шт. (при необходимости).
6. Датчики с фазированной (секторной) матрицей: S4-2, и/или S7-3t, и/или S8-3, и/или S12-4, и/или X7-2t, и/или S5-1, РУ № ФСЗ 2010/08784 - не более 15 шт. (при необходимости).
7. Датчики карандашные (волновые): D2cwc, и/или D2tcd, и/или D5cwc, РУ №ФСЗ 2010/08784 - не более 15 шт. (при необходимости).

II. Принадлежности к системе ультразвуковой диагностической в вариантах исполнения Affiniti 30, Affiniti 50:

1. Насадки для ультразвуковых датчиков с конвексной матрицей C10-4ec, производства компании CIVCO - не более 50 шт.
2. Насадки для ультразвуковых датчиков для крепления трекера положения датчика с конвексной матрицей C10-4ec, производства компании CIVCO - не более 50 шт.
3. Аккумулятор литиевый - не более 2 шт.
4. Переключатель ножной.
5. Сканер штрихкода.
6. Принтер черно-белый для печати изображений Sony UP-D711MD, производства компании Sony.
7. Принтер черно-белый для печати изображений настольный Sony UP-D898MD или Sony UP-D898DC, производства компании Sony.
8. Принтер цветной Sony UP-D25MD, производства компании Sony.
9. Термическая бумажная лента для принтера, производства компании Sony.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**А.В. Самойлова**

0122978

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 августа 2023 года № РЗН 2016/4203

Лист 2

10. Устройство видеозаписи Sony HVO-550MD, производства компании Sony.
11. Устройство подключения к беспроводной сети USB-N53 или Linksys или Rivet NGFF525A.
12. Программное обеспечение на оптическом и/или электронном и/или виртуальном носителе.
13. Кабель ЭКГ магистральный (для комплектов отведений ААМІ и ІЕС) - длина 2,7 м.
14. Отведения ЭКГ для взрослых (ААМІ) - не более 2 шт.
15. Отведения ЭКГ для взрослых (ІЕС) - не более 2 шт.
16. Отведения ЭКГ для детей (ААМІ) - не более 2 шт.
17. Отведения ЭКГ для детей (ІЕС) - не более 2 шт.
18. Кабель сетевой, длина 4 м.
19. Кабель модемный, длина 4,3 м.
20. Кабель силовой, длина 2,15 м.
21. Ванночка для дезинфекции датчиков.
22. Дисковод DVD.
- III. Система ультразвуковая диагностическая в вариантах исполнения Affiniti 70, Affiniti CVx, базовый состав:
1. Аппарат ультразвуковой в вариантах исполнения Affiniti 70, Affiniti CVx.
2. Аккумулятор литиевый, не более 2 шт.
3. Шнур питания, длина 2,15 м.
4. Руководство пользователя на бумажных и/или электронных носителях - не более 15 шт.
5. Датчики с линейной матрицей: L12-3, и/или L12-4, и/или L12-5, и/или L15-7ю, и/или L18-5, и/или VL13-5, и/или L12-3 ERGO, и/или eL18-4, РУ № ФСЗ 2010/08784 - не более 15 шт. (при необходимости).
6. Датчики с конвексной матрицей: 3D9-3v, и/или ВР10-5ес, и/или С5-1, и/или С6-2, и/или С8-5, и/или С9-4v, и/или С10-4ес, и/или V9-2, и/или mC7-2, и/или V6-2, и/или С9-2, и/или С10-3v, РУ № ФСЗ 2010/08784 - не более 15 шт. (при необходимости).
7. Датчики с фазированной (секторной) матрицей: S4-2, и/или S7-3t, и/или S8-3, и/или S12-4, и/или X7-2t, и/или S5-1, и/или S8-3t, и/или X5-1, и/или X8-2t, РУ № ФСЗ 2010/08784 - не более 15 шт. (при необходимости).
8. Датчики карандашные (волновые): D2cwc, и/или D2ted, и/или D5ewc, РУ № ФСЗ 2010/08784 - не более 15 шт. (при необходимости).
- IV. Принадлежности к системе ультразвуковой диагностической в вариантах исполнения Affiniti 70, Affiniti CVx:
1. Насадки для ультразвуковых датчиков с конвексной матрицей С10-4ес, производства

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**А.В. Самойлова**

0122979

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 августа 2023 года № РЗН 2016/4203

Лист 3

компании CIVCO - не более 50 шт.

2. Насадки для ультразвуковых датчиков для крепления трекера положения датчика с конвексной матрицей C10-4ес, производства компании CIVCO - не более 50 шт.

3. Переключатель ножной.

4. Сканер штрихкода.

5. Принтер черно-белый для печати изображений Sony UP-D711MD, производства компании Sony.

6. Принтер черно-белый для печати изображений настольный Sony UP-D898MD или Sony UP-D898DC, производства компании Sony.

7. Принтер цветной Sony UP-D25MD, производства компании Sony.

8. Термическая бумажная лента для принтера, производства компании Sony.

9. Устройство видеозаписи Sony HVO-550MD, производства компании Sony.

10. Устройство подключения к беспроводной сети USB-N53 или Linksys или Rivet NGFF525A.

11. Программное обеспечение на оптическом и/или электронном и/или виртуальном носителе.

12. Кабель ЭКГ магистральный (для отведений ААМІ и ІЕС) - длина 2,7 м.

13. Отведения ЭКГ для взрослых (ААМІ) - не более 2 шт.

14. Отведения ЭКГ для взрослых (ІЕС) - не более 2 шт.

15. Отведения ЭКГ для детей (ААМІ) - не более 2 шт.

16. Отведения ЭКГ для детей (ІЕС) - не более 2 шт.

17. Кабель сетевой, длина 4 м.

18. Кабель модемный, длина 4,3 м.

19. Кабель силовой, длина 2.15 м.

20. Комплект AI Breast:

- настольный генератор поля (ТТFG) с кабелем (при необходимости);

- настольный матрас (при необходимости);

- модуль соединения устройств (TCU) с кабелем (при необходимости);

- устройство слежения ультразвуковое для датчика ультразвукового L12-5 (при необходимости);

- устройство слежения за пациентом (при необходимости);

- кронштейн крепления устройства слежения (при необходимости);


- лоток системный (при необходимости).

21. Система объединения изображений и оперативной навигации PercuNav:

- генератор сигналов частоты полей (при необходимости);

- модуль соединения устройств (TCU) с кабелем (при необходимости);

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

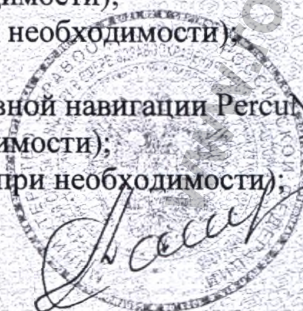

**А.В. Самойлова**

0122980

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 августа 2023 года № РЗН 2016/4203

Лист 4

- лоток системный (при необходимости);
- устройство слежения за иглами коаксиальное - не более 100 шт. (при необходимости);
- устройство слежения за иглами адаптивное - не более 6 шт. (при необходимости);
- устройство слежения за пациентом - не более 3 шт. (при необходимости);
- устройство слежения ультразвуковое - не более 5 шт. (при необходимости);
- устройство слежения ультразвуковое для датчика ультразвукового L12-5 - не более 2 шт. (при необходимости);
- устройство слежения ультразвуковое для датчика ультразвукового C10-4ес - не более 2 шт. (при необходимости);
- комплект принадлежностей нестерильный для адаптивного устройства слежения за иглами - не более 1 шт. (при необходимости);
- стойка генератора сигналов частоты полей (при необходимости).

22. Ванночка для дезинфекции датчиков.

23. Дисковод DVD.

Место производства:

1. Philips Ultrasound, LLC., 22100 Bothell Everett Highway, Bothell, Washington, 98021-8431, USA.

2. АО "РЕНТГЕНПРОМ", Россия, 143560, Московская область, г.о. Истра, тер. кв-ла №0080204, зд. №173.

3. Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd., No. 258, Zhong Yuan Road, Suzhou Industrial Park, 215024 Suzhou, Jiangsu Province, P.R. of China.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0122981